

StarLink

Mini Mikrofon Zdalny

Instrukcja obsługi



Akcesorium do
bezprzewodowych
aparatów słuchowych

CE
2797

Informacje ogólne.....	4
Podstawy użycia.....	7
Codziennie użytkowanie.....	9
Noszenie Mini zdalnego mikrofonu.....	11
Parowanie z aparatami słuchowymi.....	12
Korzystanie z Mini zdalnego mikrofonu.....	14
Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku.....	15
Montaż zasilacza.....	16
Rozwiązywanie problemów.....	17
Przeznaczenie	19
Informacje FCC	25
Informacje regulacyjne	26

Mini zdalny mikrofon został stworzony z myślą o przesyłaniu strumieniowym dźwięku z mikrofonu bezpośrednio do bezprzewodowych aparatów słuchowych 2,4 GHz. Kiedy jest noszony przez odległego mówcę w hałaśliwym otoczeniu, Mini zdalny mikrofon działa jako urządzenie wspomagające słuch.

Przesyłanie strumieniowe - Przesyłanie dźwięku bezprzewodowo z Mini zdalnego mikrofonu bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Zawartość opakowania

- Mini zdalny mikrofon
- Kabel USB - micro USB
- Instrukcja obsługi

Akcesoria opcjonalne

- Smycz (część nr 91324-000)



1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik LED
3. Mikrofon
4. Kabel USB - micro USB
5. Klips

Informacje ogólne

1. Przycisk zasilania

- Włącza i wyłącza Mini zdalny mikrofon

2. Wskaźnik LED

- Wskazuje stan Mini zdalnego mikrofonu

Dioda LED	STAN
Wył.	Zasilanie jest wyłączone
Powoli pulsujący zielony	Zasilanie jest włączone
Powoli pulsujący czerwony	Niski poziom akumulatora
Stały czerwony	Możliwy błąd

3. Mikrofon

- Podczas używania rejestruje głos mówcy

4. Kabel USB - micro USB

- Ładowanie za pomocą kabla USB - micro USB

5. Klips

- Mocuje Mini zdalny mikrofon do ubrania lub smyczy

Wskazówka: Głośność strumienia audio można regulować za pomocą aplikacji My Starkey/My Audibel, pilota i/ lub elementów sterujących aparatów słuchowych. Więcej informacji na temat konfiguracji Państwa aparatu słuchowego można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od protetyka słuchu.

Podstawy użycia

1. Aby włączyć Mini zdalny mikrofon, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy i zwolnić, gdy zaświeci się zielona dioda LED.



2. Prosimy upewnić się, że aparaty słuchowe są włączone.
 - Uwaga: Przed pierwszą transmisją strumieniową dźwięku niezbędne jest sparowanie aparatów słuchowych z Mini zdalnym mikrofonem. Patrz **Parowanie z aparatami słuchowymi** na stronie 12.
3. Aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie dźwięku,
 - Otworzyć aplikację My Starkey/My Audibel i wybrać opcję Start Streaming [Rozpocznij strumieniowanie] na ekranie Accessories [Aksesoria].
 - **Patrz Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku** na stronie 15, aby poznać dodatkowe opcje.
4. Dostosować głośność strumienia za pomocą aplikacji My Starkey/My Audibel, pilota i/ lub elementów sterujących aparatów słuchowych.

5. Aby zatrzymać przesyłanie strumieniowe:
 - Wyłączyć Mini zdalny mikrofon.
 - Otworzyć aplikację My Starkey i wybrać opcję Stop Streaming [Zatrzymaj strumieniowanie] na ekranie Accessories [Akcesoria].
 - Patrz **Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku** na stronie 15, aby poznać dodatkowe opcje.

Codzienne użytkowanie

Włączanie

Przytrzymać przycisk zasilania przez 3 sekundy i zwolnić, gdy zaświeci się dioda LED.



Wyłączanie

Przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy i zwolnić, gdy zgaśnie dioda LED.



Niski poziom akumulatora

Dioda powoli pulsuje na czerwono. Przesyła co 5 minut słyszalny sygnał dźwiękowy do aparatów słuchowych.




Ładowanie akumulatora

Wpiąć kabel USB - mikro USB do gniazda micro USB w Mini zdalnym mikrofonie.



Podłączyć kabel USB do żeńskiego gniazda USB załączonego zasilacza.



Stan ładowania


Mini zdalny mikrofon osiąga stan pełnego naładowania w czasie krótszym niż 3 godziny. W około godzinę można uzyskać naładowanie na poziomie 50%.

Zasilanie	Stan naładowania	Dioda LED
Wył.	Ładowanie	Stały zielony
Wył.	Zakończone	Wył.
Wł.	Ładowanie	Ciągłe zielone światło z krótkimi przerwami w wyniku innych wskazań LED
Wł.	Zakończone	Wył.

Wskazówka: Ładowanie Mini zdalnego mikrofonu może trwać dłużej podczas przesyłania strumieniowego audio. Ładowanie trwa krócej, gdy Mini zdalny mikrofon jest wyłączony.

Noszenie mini zdalnego mikrofonu

Mini zdalny mikrofon można przypiąć do ubrania lub nosić na smyczy. Mini zdalny mikrofon powinien znajdować się 20 cm od ust mówiącego.




Klips - Ścisnąć klips w pokazany sposób. Nasunąć klips na ubranie i zwolnić. Upewnić się, że Mini zdalny mikrofon jest bezpiecznie przypięty do ubrania.



Smycz (opcjonalnie) -

1. Ścisnąć klips w pokazany sposób.
2. Wprowadzić pętlę smyczy do otworu w klipsie i przeciągnąć w kierunku górnej części klipsa. Zwolnić klips. Upewnić się, że smycz jest bezpiecznie przymocowana do Mini zdalnego mikrofonu.
3. Zawiesić smycz na szyi.



Parowanie z aparatami słuchowymi

Aby Mini zdalny mikrofon pracował z Państwa aparatem(-ami) słuchowym(-i) niezbędne jest uprzednie sparowanie Mini zdalnego mikrofonu z każdym aparatem słuchowym. Czynność tę wystarczy wykonać raz, ponieważ powinny się one automatycznie rozpoznawać, gdy są włączone i znajdują się w zasięgu sieci bezprzewodowej.*

Aby sparować Mini zdalny mikrofon z aparatem(-ami) słuchowym(-i):

- Należy upewnić się, że aparaty słuchowe nie są podłączone do pobliskich urządzeń Bluetooth. Aby to zrobić,
 - Wyłączyć Bluetooth w telefonie komórkowym.
 - Wyłączyć wszystkie znajdujące się w pobliżu akcesoria dla Adaptera do TV, Zdalnego mikrofonu + i Mini zdalnego mikrofonu, które wcześniej zostały sparowane z aparatami słuchowymi.
- Wyłączyć, a następnie włączyć aparaty słuchowe.
 - Uwaga:** W przypadku systemu aparatów słuchowych CROS, wyłączyć zarówno aparat słuchowy, jak i nadajnik CROS. Włączyć wyłącznie aparat słuchowy, upewniając się, że nadajnik CROS pozostaje wyłączony.
- Umieścić aparaty słuchowe 15 cm od Mini zdalnego mikrofonu.

- Przy pulsującej powoli zielonej diodzie LED, kliknąć dwukrotnie miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko.



- W przypadku zestawu aparatów słuchowych:

Pierwsze mignięcie diody LED	Drugie mignięcie diody LED	Wynik parowania	Następny krok
1	2	Oba aparaty słuchowe sparowane	Zakończone
1	2	Tylko jeden aparat słuchowy sparowany	Powtórzyć kroki 1 - 5
1	nie dotyczy	Brak sparowanych aparatów słuchowych	Powtórzyć kroki 1 - 5

- W przypadku pojedynczego aparatu słuchowego:

Pierwsze mignięcie diody LED	Wynik parowania	Następny krok
1	Sukces	Zakończone
1	Niepowodzenie	Powtórzyć kroki 1 - 4 i 6


*Typowy zasięg działania wynosi do 10 metrów. Zasięg może być ograniczony w wyniku czynników środowiskowych, takich jak przeszkody, zakłócenia i położenie ciała ludzkiego. Możliwe są większe odległości, choć jakość dźwięku i łączność mogą ucierpieć.

Korzystanie z Mini zdalnego mikrofonu

W podstawowym zastosowaniu Mini zdalny mikrofon jest noszony przez znajdującego się daleko mówcę w hałaśliwym otoczeniu. Pozwala to użytkownikowi aparatu słuchowego na skupieniu się na jednej osobie, gdy występuje hałas.




Choć Mini zdalny mikrofon nie jest zoptymalizowany pod kątem użycia w charakterze uniwersalnego mikrofonu dookólnego na stół, może mimo wszystko sprawdzić się w pewnych okolicznościach. Na przykład, można spróbować umieścić Mini zdalny mikrofon w pobliżu telewizora. Komfortowy poziom głośności uzyskuje się wtedy poprzez zmianę odległości Mini zdalnego mikrofonu od głośników telewizora lub zmianę głośności strumienia audio.

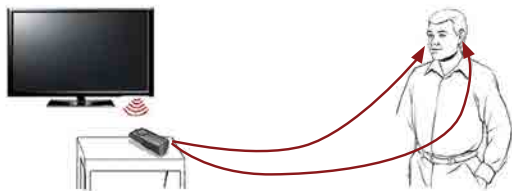

Uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z poziomu Mini zdalnego mikrofonu można uruchomić (lub zatrzymać) na różne sposoby:


- **Włączenie Mini zdalnego mikrofonu:** przesyłanie strumieniowe dźwięku automatycznie uruchamia się w aparacie słuchowym.
- **My Starkey/My Audibel:** Otworzyć aplikację w telefonie komórkowym lub tablecie. Wybrać opcję uruchomienia/zatrzymania przesyłania strumieniowego z ekranu Accessories [Akcesoria].
- **Pilot:** Jeśli został wcześniej skonfigurowany przez protetyka słuchu, należy nacisnąć przycisk Favorite [Ulubione].
- 
- **Elementy sterujące aparatu słuchowego:** w przypadku wstępnego skonfigurowania przez protetyka słuchu, określone działanie (np. długie naciśnięcie elementu sterowania) może rozpocząć/zatrzymać przesyłanie strumieniowe.

Przesyłanie strumieniowe dźwięku zostanie również zatrzymane po wyłączeniu Mini zdalnego mikrofonu. W aparatach słuchowych może zostać odtworzony sygnał dźwiękowy sygnalizujący rozpoczęcie/zakończenie przesyłania strumieniowego dźwięku.

Montaż zasilacza


Mini zdalny mikrofon może występować z różnymi konfiguracjami wtyczek do zastosowania w różnych krajach. Jeśli zasilacz wymaga montażu:

1. Wybrać odpowiednią wtyczkę stosowaną w Państwa kraju.




1

2. Wsunąć wtyczkę do zasilacza, aż do wystąpienia kliknięcia.



2

3. Aby wyjąć wtyczkę, nacisnąć zaczep i przesunąć wtyczkę w kierunku przeciwnym do kabla.



3

Rozwiązywanie problemów

OBJAW	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Jeden (lub oba) aparaty słuchowe niespodziewanie zaprzestają strumieniowego przesyłania dźwięku.	Aparaty słuchowe mogą znajdować się na granicy zasięgu transmisji bezprzewodowej.	Przysunąć się bliżej do urządzenia telewizyjnego.
	Poziom naładowania baterii w aparacie słuchowym nie pozwala na dalszy odstęp przesyłanego strumieniowo dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymienić baterię aparatu słuchowego. • Jeśli dotyczy, naładować aparat słuchowy.
	Duży obiekt, na przykład mebel lub ściana, może powodować degradację sygnału.	Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku, gdy aparaty słuchowe znajdują się w linii wzroku względem urządzenia telewizyjnego.
Połączenie bezprzewodowe z Mini zdalnym mikrofonem zostało utracone.		Aby ponownie uruchomić strumień audio, postępować zgodnie z opisem w sekcji U uruchomienie/zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku.
Przesyłany strumieniowo dźwięk jest zniekształcony.	Niski poziom naładowania akumulatora w Mini zdalnym mikrofonie.	Naładować Mini zdalny mikrofon.
Strumień audio jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	Głośność dźwięku przesyłanego z Mini zdalnego mikrofonu do aparatu słuchowego nie jest optymalna.	Dostosować głośność strumienia za pomocą aplikacji My Starkey/My Audibel, pilota i/lub elementów sterujących aparatem słuchowym.

OBJAW	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Trudno usłyszeć mowę w hałaśliwym otoczeniu.	Mini zdalny mikrofon może być zbyt daleko od mówcy.	Przesunąć Mini zdalny mikrofon bliżej ust mówiącego.
	Mini zdalny mikrofon może być zakryty odzieżą lub źle umiejscowiony.	Zapewnić dobry dostęp głosu mówcy do Mini zdalnego mikrofonu.
Przesyłany strumieniowo dźwięk jest zniekształcony.	Niski poziom naładowania akumulatora w Mini zdalnym mikrofonie.	Naładować Mini zdalny mikrofon.
Dioda LED powoli pulsuje na zielono, ale w aparatach słuchowych nie słychać przesyłanego strumieniowo dźwięku.	Aparaty słuchowe nie są gotowe do odbioru strumieni audio.	Aby uruchomić strumień audio, postępować zgodnie z opisem w sekcji Uruchomienie/ zatrzymanie strumieniowego przesyłania dźwięku.
	Aparaty słuchowe nie są sparowane z Mini zdalnym mikrofonem.	Wykonać kroki wskazane w części Parowanie z aparatami słuchowymi.
LED świeci ciągle czerwonym światłem.	Możliwy błąd.	Wyłączyć Mini zdalny mikrofon, odczekać 30 sekund, a następnie włączyć.

Przeznaczenie

Mini mikrofon zdalny jest akcesorium do bezprzewodowych aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne 2,4 GHz. Jest on przeznaczony do stosowania jako nadajnik dźwięku ze źródła audio do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne. Gdy jest noszony przez osobę mówiącą działa jako urządzenie wspomagające słyszenie.

Mini mikrofon zdalny jest sklasyfikowany jako część typu B zgodnie z normą IEC 60601-1 dotyczącą urządzeń medycznych

Mini mikrofon zdalny został zaprojektowany zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami międzynarodowej kompatybilności elektromagnetycznej. Jednak nadal możliwe jest wystąpienie zakłóceń spowodowanych przez zakłócenia linii elektrycznych, lotniskowe wykrywacze metali, pola elektromagnetyczne z innych urządzeń medycznych, sygnały radiowe i wyładowania elektrostatyczne.

Mini mikrofon zdalny jest przeznaczony do czyszczenia wilgotną szmatką zwilżoną delikatnie wodą z mydłem.

Jeśli użytkownik korzysta z innych urządzeń medycznych lub nosi wszczepialne urządzenia medyczne, takie jak defibrylatory lub rozruszniki serca, i obawia się, że mini mikrofon zdalny może powodować zakłócenia pracy urządzenia medycznego, powinien skontaktować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego w celu uzyskania informacji o ryzyku zakłóceń. Mini mikrofon zdalny nie powinien być używany podczas procedury MRI lub w komorze hiperbarycznej. Mini mikrofon zdalny nie jest formalnie certyfikowany do pracy w atmosferze wybuchowej, takiej jak w kopalniach węgla lub niektórych fabrykach chemicznych.

Zastosowanie w samolotach

Mini mikrofon zdalny nie powinien być używany w samolotach, chyba że personel pokładowy wyrazi na to zgodę.

Użycie międzynarodowe

Mini mikrofon zdalny jest zatwierdzony do działania na częstotliwościach radiowych właściwych dla danego kraju lub regionu i może nie być zatwierdzony do użytku poza danym krajem lub regionem.

Należy pamiętać, że działanie urządzenia podczas podróży międzynarodowych może powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń elektronicznych lub inne urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w działaniu mini mikrofonu zdalnego.

Your StarLink Mini Remote Microphone User Manual

Mini mikrofon zdalny jest przeznaczony do pracy, przechowywania i transportu w zakresie temperatur od -10°C (14°F) do 45°C (113°F) i wilgotności względnej od 10% do 95% oraz wysokości od 70 kPa do 106 kPa (co odpowiada wysokości od 1 200 stóp (380 m) poniżej poziomu morza do 10 000 stóp (3 000 m).

Zakres temperatur ładowania wynosi od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).

Korzyści kliniczne

Samo akcesorium nie zapewnia bezpośrednich korzyści klinicznych. Pośrednią korzyścią kliniczną jest umożliwienie urządzeniu nadrzędnemu (bezp przewodowym aparatom słuchowym) osiągnięcia zamierzonego celu.

Przepisy wymagają od nas podania następujących ostrzeżeń:

⚠ OSTRZEŻENIE: Należy unikać używania mini mikrofonu zdalnego bezpośrednio obok innych urządzeń elektronicznych, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy sprawdzić, czy aparaty słuchowe i inne urządzenia działają normalnie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, komponentów lub części zamiennych innych niż dostarczone przez producenta mini mikrofonu zdalnego może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną i zmniejszoną odporność elektromagnetyczną oraz może spowodować pogorszenie wydajności.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeśli przenośny sprzęt komunikacyjny o częstotliwości radiowej jest używany w odległości mniejszej niż 30 cm (12 cali) od mini mikrofonu zdalnego, może to spowodować pogorszenie działania aparatu słuchowego. W takim przypadku należy odsunąć się od sprzętu komunikacyjnego.

Chociaż mini mikrofon zdalny nie posiada formalnego certyfikatu (IP) ochrony przed wnikaniem pyłu lub wody, zgodnie z normą IEC 60529, został przetestowany do poziomu IP 5X. Oznacza to, że mini zdalny mikrofon jest chroniony przed kurzem.

Akumulator w mini mikrofonie zdalnym jest niewymienny. Nie należy podejmować prób wymiany akumulatora. Mini mikrofon zdalny nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Nie należy go otwierać ani modyfikować.

Zasilacz sieciowy USB używany z mini mikrofonem zdalnym musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez uznane krajowe laboratorium testowe (w Ameryce Północnej) lub spełniać obowiązujące krajowe normy bezpieczeństwa elektrycznego (w innych krajach).

Nie należy podłączać mini mikrofonu zdalnego do żadnych urządzeń, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji.

Przewidywany okres użytkowania mini mikrofonu zdalnego wynosi 3 lata.

Opis sieci bezprzewodowej

Mini mikrofon zdalny działa w paśmie 2,4-2,4835 GHz z maksymalną efektywną mocą promieniowaną 8 dBm z typem modulacji transmisji GFSK o szerokości pasma 2 MHz. Sekcja odbiorcza radia ma szerokość pasma 2 MHz.

Mini mikrofon zdalny został przetestowany i przeszedł pomyślnie następujące testy emisji i odporności:

- Wymagania normy IEC 60601-1-2 dotyczące emisji promieniowanych i przewodzonych dla urządzeń klasy B z grupy 1 zgodnie z normą CISPR 11.
- Zniekształcenia harmoniczne i wahania napięcia wpływające na źródło zasilania, zgodnie z tabelą 2 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na promieniowanie RF przy poziomie pola 10 V/m między 80 MHz a 2,7 GHz, a także wyższe poziomy pola z urządzeń komunikacyjnych, jak określono w tabeli 9 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej na poziomie pola 30 A/m oraz do zbliżeniowych pól magnetycznych określonych w tabeli 11 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na wyładowania ESD na poziomie +/- 8 kV i +/- 15 kV.
- Odporność na szybkie stany nieustalone na wejściu zasilania na poziomie +/- 2 kV przy częstotliwości powtarzania 100 Hz.
- Odporność na przepięcia na wejściu zasilania +/- 1 kV linia do linii.
- Odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola RF na wejściu zasilania zgodnie z tabelą 6 normy IEC 60601-1-2.
- Odporność na spadki i przerwy napięcia na wejściu zasilania zgodnie z tabelą 6 normy IEC 60601-1-2.

ZGŁASZANIE ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH W UE

Wszelkie poważne incydenty związane z urządzeniem należy zgłaszać lokalnemu przedstawicielowi firmy Starkey oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę. Poważny incydent definiuje się jako każdą usterkę, pogorszenie właściwości i/lub działania urządzenia lub nieprawidłowości w instrukcji obsługi/etykiecie urządzenia, które mogą doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia użytkownika LUB mogą doprowadzić do takiego pogorszenia w przypadku ponownego wystąpienia.

Informacje FCC

POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE SIECI BEZPRZEWODOWEJ

FCC ID: EOA-24RMQ

Układ scalony: 6903A-24RMQ (model 950)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz ze standardami RSS zwolnionymi z licencji ISED Canada. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urządzenia. Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Niniejszym firma Starkey Laboratories, Inc. oświadcza, że mini zdalny mikrofon jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Kopię deklaracji z g o d n o ś c i m o ż n a u z y s k a ć pod następującymi adresami oraz na stronie docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Niniejszym firma Starkey Laboratories, Inc. oświadcza, że mini zdalny mikrofon jest zgodny z brytyjskimi przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych SI 2017 z późniejszymi zmianami. Kopia brytyjskiej deklaracji zgodności można uzyskać pod następującymi adresami oraz na stronie docs.starkeyhearingtechnologies.com.

Informacje regulacyjne



Starkey Laboratories, Inc.

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA
www.starkey.com



Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Germany

Upoważniony Importer na terenie RP:
Starkey Laboratories Poland sp. z o.o.
Ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
www.starkey.com.pl



Ze zużytym sprzętem elektronicznym należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi



Przechowywać w suchym miejscu

Instrukcje dotyczące utylizacji starych urządzeń elektronicznych

Starkey Laboratories, Inc. zachęca, UE wymaga, a lokalne przepisy mogą wymagać, aby mini zdalny mikrofon był utylizowany w ramach lokalnego procesu recyklingu/ unieszkodliwiania elektroniki.

Poniższe instrukcje są przeznaczone dla osób zajmujących się utylizacją/recyklingiem. Prosimy o dołączenie tej instrukcji podczas utylizacji mini mikrofonu zdalnego.

TYLKO DLA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ UTYLIZACJĄ/RECYKLINGIEM

Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową polimerową. Aby wyjąć baterię:

- Wyłącz zasilanie mini mikrofonu zdalnego.
- Podważ połówki obudowy małym śrubokrętem.
- Odetnij przewody akumulatora od płytki drukowanej, aby zapobiec przypadkowemu zwarceniu.
- Podważ akumulator od obudowy za pomocą szerokiego płaskiego ostrza. Takie modyfikacje mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.



StarLink i Starkey są znakami towarowymi firmy Starkey Laboratories, Inc.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. P00000367 11/23 BKLT3166-01-PL-XX
Patent: www.starkey.com/patents